

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

Znak: SZP 44 / 02/2019

Chrzanów, dnia 05.02.2019

Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCNAĆ NADZIEJĄ”

Centrala

☎ 32-624-77-77

Sekretariat Dyrekcji

☎ 32-624-70-29

☎ 32-623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ 32-624-70-00

☎ 32-623-22-60

Dział Finansowo – Księgowy

☎ 32-624-70-12

Dział Kontraktów Medycznych i Statystyki

☎ 32-624-70-07

☎ 32-624-75-13

Dział Organizacji i Kadr

☎ 32-624-70-06

☎ 32-624-75-10

Sekcja Zamówień Publicznych

☎ 32-624-70-30

☎ 32-624-70-34

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi do przetargu „Dostawa obłożeń” – sprawa nr 03/2019.

1. dotyczy pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 zestawu dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ tj.:

- Serweta do artroskopii kolana posiadająca 2 elastyczne otwory Ø5 cm (zamiast 1)
- Elastyczna osłona ortopedyczna na kończynę w wymiarze 22x75 cm (zamiast 30x80cm)
- 4szt ręczniki do rąk (zamiast 2szt)


Wszystkie pozostałe elementy zestawu zgodne z opisem SIWZ.

Odp: Zgodnie z siwz.

2. dotyczy pakietu nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie pakietu nr 3 zestawu w składzie jak niżej?

- 1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm
- 1 ręcznik do rąk
- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta TUR 175/270 x 170 cm zintegrowana, z osłoną na palec o średnicy 3cm, otworem o średnicy 6cm i przylepnym otworem o średnicy 8cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)






Odp: Zgodnie z siwz.

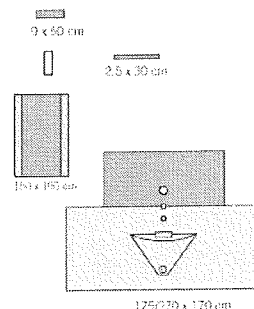

3. dotyczy pakietu nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 zestawu w składzie jak niżej:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta 100 x 150cm 2-warstwowa na całej powierzchni
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

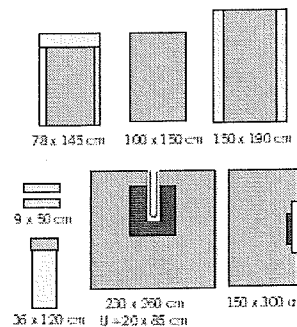

NIP: 628-19-16-916

Regon: 000310108

KRS:0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

Serwety wykonane z mocnego i chłonnego laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m², z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze 80g/m² (całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m²).

Odp: Zgodnie z siwz.

4. **dotyczy Pakietu nr 5:** Czy Zamawiający oczekuje fartuchów pełnobarierowych 5-cio warstwowych SMMMS zapewniających pełną ochronę użytkownika?

Odp: Nie.

5. **dotyczy Pakietu nr 5:** Czy Zamawiający oczekuje, żeby fartuchy zapakowane były w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego?

Odp: Nie.

6. **dotyczy Pakietu nr 8:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 zestawu z serwetami wykonanymi z laminatu trójwarstwowego (2 x włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) w strefie dedykowanej dla Pacjenta o gramaturze 75g/m² z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze 80g/m² (całkowita gramatura w części chłonnej 155g/m²)?

Odp: Tak.

7. **dotyczy Pakietu nr 12:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm

1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm (+/-5 cm)

1 osłona ortopedyczna na kończynę **22x75cm**

2x taśma foliowa samoprzylepna **9cm** x 50 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 190 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 230cm x **300 cm** z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trójwarstwowego w strefie dedykowanej dla pacjenta: 2 x włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50cm). Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.

Odp: Zgodnie z siwz.

8. **dotyczy Pakietu nr 12:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm

1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm (+/-5 cm)

1 osłona ortopedyczna na kończynę **36x65cm**

2x taśma foliowa samoprzylepna **9cm** x 50 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 190 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 230cm x **300 cm** z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (75x80cm). Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795. Zestaw posiada

4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta.

Odp: Zgodnie z siwz.

9. **dotyczy Pakietu nr 16:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Zestaw do cięcia cesarskiego:

1. serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm 1 szt
2. serweta na stolik Mayo- standard 78x145cm 1 szt
3. serweta do cięcia cesarskiego z otworem wypełnionym folią o wymiarach około 36x36 cm z torbą na płyny
4. serweta/kocyk dla noworodka **75x120cm**
5. taśma samoprzylepna
6. ręczniki do rąk **30,5 x 34cm** - 4 szt

Obłożenie spełnia wymogi normy EN 13795. Wszystkie wymienione elementy składowe mają być zawarte w pakiecie

Odp: Nie.

10. **Dotyczy Pakietu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16:** Czy Zamawiający dopuści próbki po 2 sztuki z każdej pozycji w wersji niewysterylizowanej? Zapakowane będą w oryginalne opakowania do sterylizacji, wraz z etykietami. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej dostarczać będziemy asortyment w wersji wysterylizowanej.

Odp: Zgodnie z siwz.

11. **Dotyczy SIWZ:** Czy Zamawiający dopuści złożenie wraz z oferta oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej?

Odp: Zgodnie z siwz.

12. **Dotyczy SIWZ:** Zwracamy się do Zamawiającego o przesunięcie terminu złożenia ofert o min. 5 dni roboczych. Czas ten pozwoli potencjalnym oferentom przygotować niezbędne próbki sterylne do przetargu, przez co zwiększy się konkurencyjność złożonych ofert z korzyścią dla Szpitala.

Odp: Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na 13.02.2019r.

13. **Pakiet 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:


Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące

informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.
Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

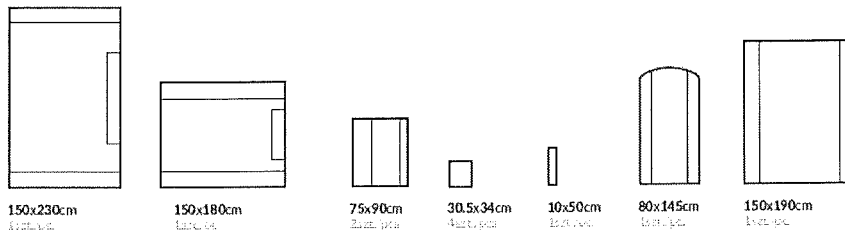

Odp: Zgodnie z siwz.


14. Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m²:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

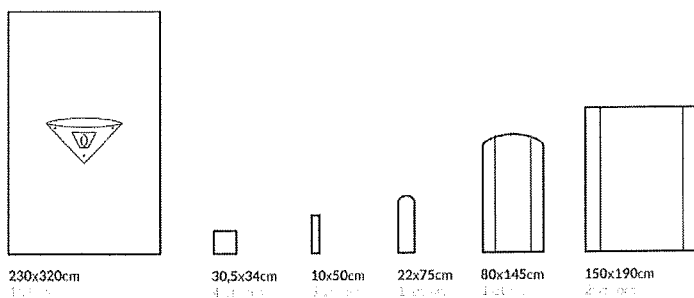

Odp: Zgodnie z siwz.

15. Pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z wycięciem U w rozmiarze 200cm x 260cm przy zachowaniu pozostałych parametrów zestawu?

Odp: Tak, nastąpiła omyłka pisarska – Zamawiający wymaga w poz. 3 serweta 200x250 cm (+/-10).

16. Pakiet 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:


Zestaw serwet do operacji otolaryngologicznych o minimalny składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo-foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

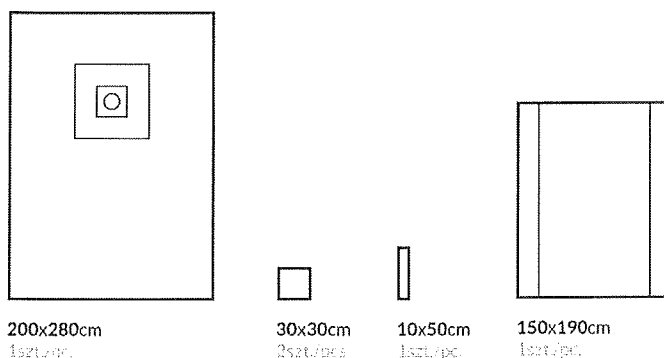

Odp: Tak.

17. Pakiet 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ręczników pakowanych po 1 sztuce z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp: Tak.

18. Pakiet 10, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśm w rozmiarze 10 x 50cm?

Odp: Tak.

19. Pakiet 10, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony w rozmiarze 35 x 120cm + 1 taśma?

Odp: Zgodnie z siwz.

20. Pakiet 11, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 120cm?

Odp: Zgodnie z siwz.

21. **Pakiet 11, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 100 x 150cm?

Odp: Zgodnie z siwz.

22. **Pakiet 11, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 7cm?

Odp: Tak.

23. **Pakiet 11, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z otworem 6 x 8cm?

Odp: Nie.

24. **Pakiet 12** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

Zestaw serwet do artroskopii:


Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m²:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stół instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stół Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

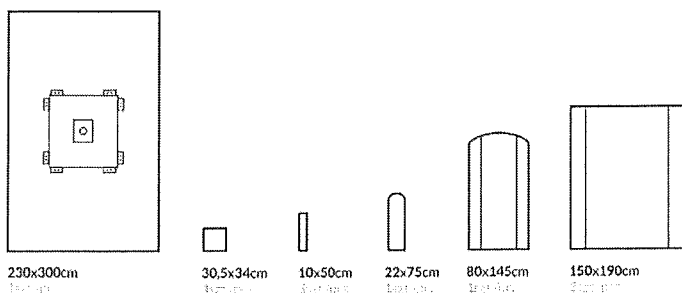


Odp: Tak.

Obłożenie do operacji kończyny:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

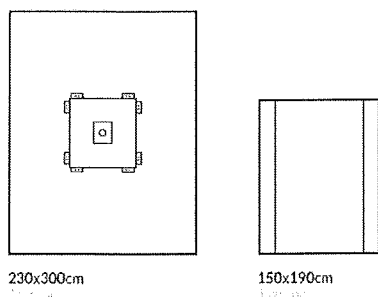

Odp: Tak.

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego:


Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo-foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serwetka stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i

naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

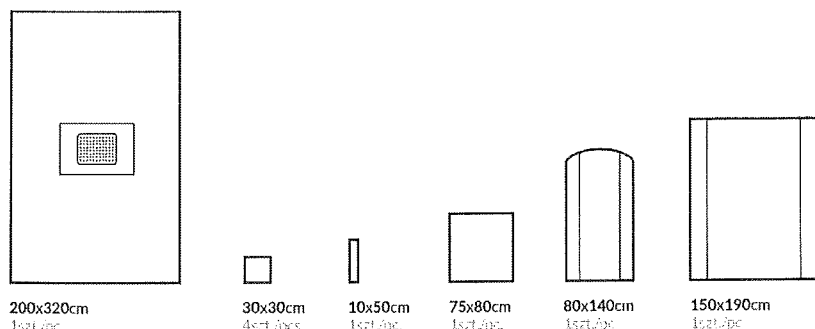

Odp: Nie dopuszczamy. Nastąpiła omyłka pisarska w pkt.3 pakietu - Zamawiający oczekuje w pkt. 3 serweta do cięcia cesarskiego z otworem o wymiarach 25cmx30cm otoczonym folią z torbą na płyny; wymiary serwety 250x300 cm (+/-10 cm).

27. Pakiet 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	320x240	OKRĄG	6
pokrowiec na nogę	1	75x37		
taśma medyczna	2	50x9		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	2	40x20		

Odp: Zgodnie z siwz.

28. Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z otworem elastycznym, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu i zintegrowanymi nogawicami	1	215x180	OKRĄG	5; 4
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serwetki do rąk	2	40x20		
taśma medyczna	1	50x9		

Odp: Zgodnie z siwz.

29. Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	260x240	WYCIĘC. U	100x20
serweta z przylepcem	1	240x150		
pokrowiec na nogę	1	120x37		
kieszonka na płyny z kształtką	1	40x30		
taśma medyczna	6	50x9		
serwetki do rąk	4	40x20		

Odp: Zgodnie z siwz.

30. Pakiet 8. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	4	40x20

Odp: Tak.

31. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści ręczniczki w rozmiarze 50x40cm pakowane a 1 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp: Zgodnie z siwz.

32. Pakiet 11 poz.1. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130x90cm?

Odp: Tak.

33. Dotyczy Pakiet 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu wyposażonego w 2 włókninowe OP Taśmy w miejsce taśmy samoprzylepnej? Pozostały skład i wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp: Tak.

34. Dotyczy Pakiet 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii składającego się z następujących składowych:

- ☐ ☐ 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- ☐ 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm;
- ☐ 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 80cm;
- ☐ 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
- ☐ 1 serweta 100 x 150cm;
- ☐ ☐ 1 foliowa osłona na przewody (złożona teleskopowo) 15 x 250 cm;
- ☐ ☐ 1 serweta główna 200x 300cm z otworem o średnicy 7 cm, otoczonym łata chłonną w rozmiarze 50 x 50cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów

wyposażony w kształtkę (szywnik), zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odp: Zgodnie z siwz.

35. Dotyczy Pakiet 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu TUR (urologiczny) się z następujących składowych:

- ☐ ☐ 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- ☐ 4 ręczniki 30 x 40cm
- ☐ 1 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm
- ☐ 1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x 200cm z otworem z osłoną na palec do badania per rectum; otwór o średnicy 6 cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; otwór samoprzylepny w rozmiarze 6 x 8cm
- ☐ 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odp: Zgodnie z siwz.

36. Dotyczy Pakiet 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu trójwarstwowego do operacji biodra składającego się z następujących składowych:

- ☐ ☐ 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- ☐ 1 serweta 75 x 90cm
- ☐ 1 serweta 150 x 200cm
- ☐ 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- ☐ 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- ☐ 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm
- ☐ 2 OP Taśmy 10 x 50cm
- ☐ 1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm,
- ☐ 1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia

Odp: Zgodnie z siwz.

37. Dotyczy Pakiet 12: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii składającego się z następujących składowych:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- ☐ 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm; (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- ☐ 2 OP taśmy 10 x 50cm,
- ☐ 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 90cm
- ☐ ☐ 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- ☐ ☐ 1 serweta główna 230cm x 320cm z samouszczelniającym otworem (ø 7cm), dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 50cm (część krytyczna pola operacyjnego), dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Pozostałe wymagania dotyczące zestawu zgodnie z SIWZ

Odp: Zgodnie z siwz.

38. Dotyczy Pakiet 16: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego składającego się z następujących składowych:

- ☐ ☐ 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
 - ☐ 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
 - ☐ 1 serweta do owinięcia noworodka 80 x 80cm;
 - ☐ 4 ręczniki 30 x 40cm;
 - ☐ 1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (szybownik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
 - ☐ 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów
- Pozostałe wymagania dotyczące zestawu zgodnie z SIWZ.

Odp: Nie dopuszczamy. Nastąpiła omyłka pisarska w pkt.3 pakietu - Zamawiający oczekuje w pkt. 3 serweta do cięcia cesarskiego z otworem o wymiarach 25cmx30cm otoczonym folią z torbą na płyny; wymiary serwety 250x300 cm (+/-10 cm).

39. Dotyczy SIWZ Pakiet 1: Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki z powodu bardzo wysokiego kosztu przygotowania oferty.

Odp: Zgodnie z siwz.

40. Dotyczy SIWZ Pakiet 2: Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki z powodu bardzo wysokiego kosztu przygotowania oferty.

Odp: Zgodnie z siwz.

41. Dotyczy SIWZ Pakiet 3: Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki z powodu bardzo wysokiego kosztu przygotowania oferty.

Odp: Zgodnie z siwz.

42. Dotyczy SIWZ Pakiet 4: Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki z powodu bardzo wysokiego kosztu przygotowania oferty.

Odp: Zgodnie z siwz.

43. Dotyczy SIWZ Pakiet 5: Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki z rozmiaru L i XL z powodu bardzo wysokiego kosztu przygotowania oferty.

Odp: Zgodnie z siwz.

44. Dotyczy SIWZ Pakiet 12: Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki z powodu bardzo wysokiego kosztu przygotowania oferty.

Odp: Zgodnie z siwz.

45. Dotyczy SIWZ Pakiet 16: Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki z powodu bardzo wysokiego kosztu przygotowania oferty.

Odp: Zgodnie z siwz.

46. Dotyczy Umowy § 3 pkt. 7: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) -

podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmiennym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc pod uwagę powyższe, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Odp: Zgodnie z siwz.

47. **Do Umowy § 5 pkt. b):** W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odp: Adres mailowy apteki szpitalnej – apteka@szpital-chrzanow.pl

48. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie **w pakiecie nr 1 w pozycji nr 1** w obłożeniu uniwersalnym 2 warstwowym w miejsce serwety w pozycji nr 2. Serweta z przylepcem rozmiar 170cm x 190 cm x 1szt – serwetę w rozmiarze 170cm x 175cm x 1szt, reszta parametrów bez zmian.

Odp: Zgodnie z siwz.

49. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie **w pakiecie nr 3 w pozycji nr 1** zestawu do zabiegów urologicznych w miejsce serwety w pozycji nr 2. serweta do operacji resekcji przezcewkowej z otworem brzuszny i kroczyzowy oraz osłoną palca i kieszeni do zbiórki płynów rozmiar około 190 x 230 c(+/-10 cm) – serwetę główną w rozmiarze 185x260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3cm oraz posiadający dodatkowo w swoim składzie 1 rurkę drenową o długości 1,5 m, reszta parametrów bez zmian.

Odp: Zgodnie z siwz.

50. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie **w pakiecie nr 8 w pozycji nr 1** obłożenia uniwersalnego 2-warstwowego uniwersalnego dodatkowo wzmocnionego: wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Odp: Zgodnie z siwz.

51. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie **w pakiecie nr 11 w pozycji nr 1** sterylnej pełnobarierowej serwety w rozmiarze 100x150cm.

Odp: Tak.

52. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie **w pakiecie nr 11 w pozycji nr 4** serwety dwuwarstwowej sterylnej posiadającej otwór okrągły samoprzylepny położony centralnie w rozmiarze 6x8cm, reszta parametrów bez zmian.

Odp: Nie.

53. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 16 w pozycji nr 1 obłożenia do cięcia cesarskiego w miejsce serwety w pozycji nr 3. serweta do cięcia cesarskiego z otworem otoczonym folią o wymiarach około 25 cm - 30 cm z torbą na płyny – serwetę w kształcie litery T o wymiarach 200/250x315cm z przylepnym oknem o wymiarze 18x28x32cm z folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wymiarze 80x80cm z dwoma zaworami i kształtownikiem, w miejsce serwety w pozycji nr 4. serweta/kocyk dla noworodka 60-80cm – serwetę do owinięcia noworodka wykonaną z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o wym. 90x100cm, zestaw zawierający w swoim składzie 2 ręczniki w rozmiarze 30x40cm oraz 2 ręczniki w rozmiarze 30x40cm pakowane oddzielnie z wyceną za cały komplet, reszta parametrów bez zmian.

Odp: Tak, dopuszczamy.

54. **Pakiet 1 poz. 1 – Obłożenie uniwersalne 2 warstwowe** : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 150x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x145 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x uchwyt na przewody typu Velcro 2x11 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), serweta na stół Mayo w postaci worka, składana teleskopowo.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odp: Tak.

55. **Pakiet 1 poz. 1 – Obłożenie uniwersalne 2 warstwowe**
Czy Zamawiający oczekuje aby serwety okrywające pacjenta były chłonne na całej ich powierzchni ?

Odp: Nie.

56. **Pakiet 2 poz. 1 – Zestaw do artroskopii**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii o składzie:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 152 x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x142 cm
- 1 x stokineta 37,5 x 55 cm - 2 x taśma przylepna, 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do artroskopii 221/290 x 322 cm z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, torba na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka, 2 uchwyty na przewody typu rzep, serweta wykonana z chłonnego bilaminatu (polipropylen, polietylen)
- 1x osłona na kamerę 13 x 240 cm

Odp: Zgodnie z siwz.

- 57. Pakiet 2 poz. 1 - Zestaw do artroskopii:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje serwety prostej czy w kształcie litery T.

Odp: Zgodnie z siwz.

- 58. Pakiet nr 3 poz. 1 – Urologia :** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do resekcji przezcewkowych w składzie:
- 1 serweta na stół narzędziowy 140x190 cm
 - 1 taśma przylepna 9x50 cm
 - 2 ręczniki chłonne 30x20 cm
 - 1 serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 175/290x242 cm, z przylepnym otworem brzuszny $\varnothing$ 8 cm, z otworem na pręcie $\varnothing$ 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka.

Odp: Tak.

- 59. Pakiet 4 poz. 1 – Obłożenie biodro :** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji biodra w składzie:
- stół narzędziowy 140 x 190
 - 1 osłona na stół Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 100x75cm
 - 1 stokineta z bilaminatu 30x120
 - 1 przylepna serweta dolna z bilaminatu 190x190cm, długi przylepiec 85cm
 - 1 przylepna serweta górna z bilaminatu 300x221cm, długi przylepiec 130cm
 - 1 przylepna serweta dzielona z bilaminatu 230x305cm, wzmocnienie 70x99cm, przylepne wycięcie 15x117cm, 2 uchwyty na przewody
 - 5 przezroczystych taśm lepnych 8x40 cm
- Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu ze wzmocnieniem

Odp: Zgodnie z siwz.

- 60. Pakiet 5 poz. 1,2**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartuchów nie kompletnych w ręczniki chłonne lub z ręcznikami pakowanymi osobno.

Odp: Zgodnie z siwz.

- 61. Pakiet 8 poz. 1 – Obłożenie uniwersalne 3W:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu podstawowego o składzie:
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm (owinięcie zestawu)
 - 1 x serweta na stół Mayo 80x142cm
 - 1 x serweta min. 196x200 cm , przylepna
 - 1 x serweta min. 160x260cm , przylepna
 - 2 x serweta min. 75x98cm , przylepna na całej długości dłuższego boku
 - 1 x taśma typu rzep min. 2,5x13cm
 - 4 x ręcznik chłonny 20x30cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego chłonnego laminatu , trójwarstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen , polipropylen).

Odp: Tak.

- 62. Pakiet 8 poz. 1 – Obłożenie uniwersalne 3W:** Czy Zamawiający oczekuje aby serwety okrywające pacjenta były chłonne na całej ich powierzchni ?

Odp: Tak.

- 63. Pakiet 8 poz. 1 - Obłożenie uniwersalne 3W:** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy przez wymóg łatwopalny należy rozumieć produkt niezawierający wiskozy i celulozy.

Odp: Tak.

- 64. Pakiet 8 poz. 1 - Obłożenie uniwersalne 3W:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów sterylizowanych radiacyjnie, co skutkuje lekko nieprzyjemnym zapachem oraz lekko pogniecionymi serwetami, lecz zwiększa konkurencyjność postępowania.

Odp: Zgodnie z siwz.

- 65. Pakiet 10 poz. 2.:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony ortopedycznej na kończynę w rozmiarze 36,5 cm x 72 cm + 1 taśma lepna 9 x 50 cm.

Odp: Zgodnie z siwz.

- 66. Pakiet 12 poz. 1 - Endoproteza kolano:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu:
- 2 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm
 - 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm wzmocnienie 88x55cm
 - 1 x stokineta 36,5x72 cm 2-warstwowa
 - 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm
 - 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
 - 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odp: Zgodnie z siwz.

- 67. Pakiet 16 poz. 1 – Zestaw do cięcia cesarskiego:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:
- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm
 - 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm
 - 1 x kocik dla noworodka 100x105 cm
 - 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z osłonami ramion stołu, otwór 30x36cm wypełniony folią operacyjną z dodatkowymi przylepcami, ze zintegrowaną torbą na płyny, 4 uchwyty na przewody, serweta wykonana z trilaminatu (polipropylen, polietylen, polipropylen)
 - 2 ręczniki chłonne 30x20cm

Odp: Nie dopuszczamy. Nastąpiła omyłka pisarska w pkt.3 pakietu - Zamawiający oczekuje w pkt. 3 serweta do cięcia cesarskiego z otworem o wymiarach 25cmx30cm otoczonym folią z torbą na płyny; wymiary serwety 250x300 cm (+/-10 cm).

- 68. Pakiet 16 poz. 1 – Zestaw do cięcia cesarskiego:** Czy Zamawiający wymaga obłożenia do cięcia cesarskiego ze wzmocnieniem zarówno w okolicy otworu, jak i dodatkowego na kończynach pacjentki?

Odp: Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza.

- 69. Pakiet 16 poz. 1 – Zestaw do cięcia cesarskiego:** Prosimy o doprecyzowanie czy serweta do cięcia cesarskiego powinna mieć kształt litery T dzięki czemu poprzez wytworzenie

obszernego ekranu anestezyjologicznego istnieje możliwość zabezpieczenia ramion stołu operacyjnego.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

70. Zadanie nr 1 poz. 1: Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej oferty, prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie i wymiarach serwet:

- serweta przylepna 150 x 240 cm
 - serweta przylepna 175 x 175 cm
 - serweta przylepna 75 x 90 cm – 2 szt.
 - ręczniki 30 x 40 cm – 4 szt.
 - taśma lepna 9 x 49 cm
 - serweta na stolik 140 x 190 cm
 - osłona Mayo 79 x 145 w kolorze niebieskim,
- opakowanie folia – papier z 3 etykietami, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odp: Zgodnie z siwz.

71. Pakiet 2 : Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do artroskopii w którego skład wchodzi:

- Serweta do artroskopii 225 x 320 cm z elastycznym otworem 6+7 cm , ze zintegrowaną torbą na płyny , zaworem do podłączenia drenu
- Osłona na kończynę 33 x 55 cm
- Serweta nieprzylepna 150 x 180 cm
- Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
- Pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 2 ręczniki celulozowe do rąk
- 1 taśma samoprzylepna w zestawie lub druga dodatkowo pakowana oddzielnie do zestawu?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odp: Tak.

72. Pakiet 3 : Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do resekcji przezcewkowych, w którego skład wchodzi:

- Serweta do procedur TUR 225/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w okolicy odbytu 5 cm , otworem nadłonowym 8 cm , ze zintegrowaną torbą na płyny w tym z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu oraz z bezłateksową osłoną na palec
- Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
- uchwyt typu rzep do mocowania przewodów i drenów?
- 2 ręczniki celulozowe do rąk

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odp: Tak.

73. Pakiet 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra wykonany z włókniny trzywarstwowej w strefie krytycznej o następującym składzie i rozmiarach:

- Serweta wzmocniona na stolik Mayo 80x145
- Serweta na stolik narzędziowy 150 x 190cm
- Serweta z wycięciem U wzmocnienie w części krytycznej 225 x 280 cm , wycięcie U o wymiarze 10 x 100 cm
- serweta z przylepcem wzmocnienie w części krytycznej 225 x 270 cm, z wycięciem 45x65cm
- Serweta podkład pod biodro 150x180cm
- Serweta samoprzylepna 90x75cm
- nogawica 33 x 110 cm
- 3 taśmy przylepne

- 4 ręczniki do rąk ?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odp: Tak.

74. Pakiet 6: Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu wszczepiania rozrusznika o następującym składzie i rozmiarach:

- 1 serweta 150 x 240 cm z dwoma otworami (przylepne, okrągłe, umieszczone decentralnie) o średnicy 12 cm
- 1 serweta celulozowa 80 x 100 cm jako owinięcie zestawu
- 1 ręcznik celulozowy 30x40 cm
- 1 taśma samoprzylepna ?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odp: Nie.

75. Pakiet 11 poz 1-4: Czy zamawiający wymaga aby gramatura laminatu oferowanych serwet wynosiła min 57,0 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odp: Zgodnie z siwz.

76. Pakiet 14 : Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem samouszczelniającym o średnicy 3 cm Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odp: Tak.

77. Pakiet 16 : Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80x 145cm
- 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 x 335 cm z otworem 27 x 33 cm otoczonym (rozmiar okna 14 x 20 cm)z torbą na płyny
- 1 serweta dla noworodka 90x100cm
- 4 ręczniki do rąk 30cm x40cm -

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odp: Zgodnie z siwz.

78. Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do resekcji przezcewkowych posiadającego serwetę główną w rozmiarze 185 x 200 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Tak.

79. Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z laminatu 2-warstwowego oraz z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm
- 1 samoprzylepna serweta typu „U” z dodatkową warstwą ("U"10x95cm) 245x280cm
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
- 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
- 2 taśmy samoprzylepne
- 4 ręczniki celulozowe do osuszania rąk

Odp: Zgodnie z siwz.

80. Pakiet 6 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie 1 ręcznik celulozowy? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Tak.

81. Pakiet 8 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z laminatu 2-warstwowego oraz z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)
- 1 samoprzylepna serweta z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)
- 2 samoprzylepne serwety z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)
- 1 taśma samoprzylepna
- 4 ręczniki celulozowe do osuszania rąk

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Zgodnie z siwz.

82. Pakiet 11 Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej sterylnej w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem okrągłym samoprzylepnym położonym centralnie o średnicy 7 cm, nieprzepuszczalną dla płynów?

Odp: Tak.

83. Pakiet 12 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z laminatu 2-warstwowego oraz z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm (pad 105 x 150 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Tak.

84. Pakiet 13 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z laminatu 2-warstwowego oraz z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta dwuwarstwowa przylepna 170 x 175 cm
- 1 serweta dwuwarstwowa przylepna 240 x 150 cm
- 2 serwety dwuwarstwowa przylepna 90 x 75 cm
- 1 fartuch chirurgiczny SMMMS niewzmocniony L, dł. 125 cm
- 1 fartuch chirurgiczny SMMMS niewzmocniony XL, dł. 140 cm
- 2 ręcznik celulozowy do osuszania rąk

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Zgodnie z siwz.

85. Pakiet 14 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety do operacji na kończynie (ręka/stopa) o wymiarach 245 x 320 cm posiadającą samouszczelniający otwór o średnicy 3 cm otoczony warstwą chłonną?

Odp: Tak.

86. Pakiet 15 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety do owinięcia noworodka w rozmiarze 87 x 90 cm?

Odp: Tak.

87. Pakiet 16 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm) 315 x 250 cm
- 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm
- 1 taśma samoprzylepna
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Zgodnie z siwz.

88. WZÓR UMOWY § 7 – Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 7 wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp: Zgodnie z siwz.

UWAGA: Zamawiający informuje, że przesunął termin składania i otwarcia ofert na 13.02.2019r. Miejsca oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

P.O. DYKBA
Szpitala Powiatowego w Chorzowie
mgr Alicja Dobrowolska

Sporządził:

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Anna Pawłowska